



日本国特許庁
PATENT OFFICE
JAPANESE GOVERNMENT

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日

Date of Application:

1999年 3月26日

出願番号

Application Number:

平成11年特許願第083744号

出願人

Applicant(s):


株式会社日立メディコ

RECEIVED
JUN - 9 2000
TC 3700 MAIL ROOM

2000年 3月17日

特許庁長官
Commissioner,
Patent Office

近藤 隆彦



出証番号 出証特2000-3018510

【書類名】 特許願

【整理番号】 H9907

【提出日】 平成11年 3月26日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 A61B 5/055

【発明の名称】 磁気共鳴イメージング装置および磁気共鳴イメージング装置における高い磁場均一度を維持する方法

【請求項の数】 4

【発明者】

【住所又は居所】 東京都千代田区内神田 1 丁目 1 番 1 4 号 株式会社 日立メディコ内

【氏名】 津田 宗孝

【特許出願人】

【識別番号】 000153498

【氏名又は名称】 株式会社 日立メディコ

【代表者】 宅間 豊

【代理人】

【識別番号】 100099852

【弁理士】

【氏名又は名称】 多田 公子

【選任した代理人】

【識別番号】 100099760

【弁理士】

【氏名又は名称】 宮川 佳三

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 035725

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1
【物件名】 要約書 1
【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 磁気共鳴イメージング装置および磁気共鳴イメージング装置における高い磁場均一度を維持する方法

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 一定の磁場強度の静磁場を発生する静磁場発生手段と、磁場強度勾配を発生する傾斜磁場発生手段と、高周波磁場を発生する手段と、被検体から発生する核磁気共鳴信号を検出する手段と、前記核磁気共鳴信号を処理し、その結果を表示する手段とを備えた磁気共鳴イメージング装置において、

前記静磁場の空間分布を均一にする付加的磁場を発生する磁場補正手段と、

前記静磁場発生手段および／又はその周辺の温度を検出する手段と、

前記温度検出手段が検出した温度に基づいて前記磁場補正手段を制御する手段とを備えたことを特徴とする磁気共鳴イメージング装置。

【請求項 2】 前記制御手段は、前記温度検出手段が検出した温度を設定する手段を備えたことを特徴とする請求項 1 記載の磁気共鳴イメージング装置。

【請求項 3】 磁気共鳴イメージング装置において静磁場発生手段が発生する静磁場を、付加的な磁場を発生させて均一に維持する方法であって、

前記静磁場の空間分布の不均一成分の温度依存性を求めるステップと、

前記静磁場発生手段の温度を検出するステップと、

前記検出された温度および前記温度依存性に基づき前記付加的磁場の強度を求めるステップとを含むことを特徴とする方法。

【請求項 4】 温度検出から付加的磁場の発生までを常時動作させることを特徴とする請求項 3 記載の方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明が属する技術分野】

本発明は磁気共鳴イメージング（以下MRIと称する）装置に係わり、特に、磁場の均一度を高い値に維持し、高画質を得るのに好適MRI装置と方法に関する。

【0002】

【従来の技術】

核磁気共鳴（NMR）現象を利用して人体の断層画像を得るMRIは広く医療機関で利用されている。このMRIは正確に被検体の検査部位の内部構造を反映する必要から、検査部位を含む空間に均一な磁場強度の磁場を発生する磁石を必要としている。原理的に、均一な磁場空間は無限長のソレノイドコイル内で得られることから、MRI装置に用いられる磁石の多くは細長い筒状のソレノイドコイルと磁場均一度を改善するシム機構が組込まれた構造となっている。

【0003】

細長い空間に被検者を配設するMRIに対して、奥行の短い磁石構造や開口部を広げた解放的な磁石構造を採用し、検査に伴う被検者の圧迫感を和らげ、或いはMRIの検査中に治療を行うインターベンショナル手技を可能にしたMRI装置が開発されている。

【0004】

これら、奥行の短い磁石や解放的な構造の磁石では、磁気回路を構成するために鉄ヨークが用いられているが、鉄ヨークの熱膨張によりその磁場強度や磁場均一度が温度によって変化するという問題がある。

【0005】

この問題の解決策として、磁石自体を一定の温度に保つように温度制御を行う方法があり、例えば特許第2566410号公報にこの種の技術が記載されている。

【0006】

一方、静磁場の均一度を改善するシム機構としては静磁場の不均一性を解消するように磁性体小片を配置するパッシブシミングと、静磁場不均一の変動に応じてシムコイルに流す電流を変化させるアクティブシミングとがある。アクティブシミングの一手法として被検体から検出したNMR信号を解析して磁場の不均一度を求め、これに基づきシムコイルに流す電流を制御する方法等が提案されている（例えば米国特許第5530352号公報）。

【0007】

【発明が解決しようとする課題】

上述した磁石自体の温度制御を行なう方法は、磁石の構造や形態に関わらず安定した磁場を発生させることができる有効な方法であるが、さらに以下のような

改善すべき点がある。

(1) 磁石を一定温度に保つために通常室温より高い温度に維持することが必要であるため、磁石を高温槽で囲まなければならない、被検体を配設する空間を狭めることになる。

(2) 熱容量の大きな磁石を一定の温度に保つためには検査に使用する相当以前から温度制御回路を動作させて置かなければならない。現実的には連続的に通電状態にしておくことになるが、停電した場合は磁石の温度が再び安定になるまでの期間は装置が使用できない。

(3) 磁石の温度制御回路の能力とその追従速度の限界を越えるような大幅な温度変化や急激な温度変化が磁石周辺に起こった場合には対処できない。

【0008】

さらに、高度の磁場均一度を必要とする撮影手法（例えば、脂肪信号のみを抑制した画像やエコープレーナイメージングEPI等）では、これまで以上に高精度で温度制御し、磁場均一度を安定に維持することが要求されている。

【0009】

一方、被検体のNMR信号を用いて磁場の不均一性を改善する方法は、被検体を磁石に配設してから磁場均一度の調整を行わなければならない、目的とするMRIの検査効率が低下するという問題がある。また磁場不均一性は被検体の部位や配設位置によって異なるために調整が複雑となり、温度に依存する不均一性を効率よく改善できないという問題があった。

【0010】

本発明は上記観点に鑑みてなされたもので、温度の変化に影響されことなく磁場均一度を安定に維持することができるMRI装置および方法を提供することを目的とする。また本発明は高度の磁場均一度を達成することができ、MRI検査データの質的向上を達成したMRI装置を提供することを目的とする。

【0011】

【課題を解決するための手段】

上記目的を達成する本発明のMRI装置は、一定の磁場強度の静磁場を発生する静磁場発生手段と、磁場強度勾配を発生する傾斜磁場発生手段と、高周波磁場を

発生する手段と、被検体から発生する核磁気共鳴信号を検出する手段と、前記核磁気共鳴信号を処理し、その結果を表示する手段とを備え、さらに前記静磁場の空間分布を均一にする付加的磁場を発生する磁場補正手段と、前記静磁場発生手段および／又はその周辺の温度を検出する手段と、前記温度検出手段が検出した温度に基づいて前記磁場補正手段を制御する手段とを備えている。

【0012】

検出温度に基づき磁場補正手段を制御して静磁場不均一を補正することにより温度に依存する磁場の不均一性を応答性よく改善することができる。従って大幅な温度変化や急激な温度変化にも対応することができる。また静磁場発生手段の温度を一定に保つための高温槽をなくすことができるので、被検体の置かれる測定空間を広くすることができ、インターベンショナルなどの作業性をよくすることができる。

【0013】

本発明のMRI装置において、磁場補正手段はシムコイルとシムコイルに電流を供給する手段とを備え、制御手段はシムコイルに供給する電流を制御することにより静磁場の均一度を改善する。

【0014】

制御手段における磁場補正手段の制御は、好適には、静磁場の空間分布の不均一成分の温度特性に基づき行なう。不均一成分の温度特性は予め求めておくことができ、制御手段は検出された温度とこの温度特性から検出温度における不均一成分の量を求め、これを相殺する付加的な磁場を発生するように磁場補正手段を制御する。

【0015】

また本発明のMRI装置において、温度検出手段は測定室内に設置した温度計がこれを兼ねることができ、その場合には検出温度を制御手段に与えるための温度設定手段を備えていることが好ましい。制御手段は温度設定手段に設定された測定室内の温度に基づき、磁場補正手段を制御する。温度設定手段で設定する温度は、数値でも定性的パラメータでもよい。

【0016】

本発明の静磁場均一度維持方法は、MRI装置において静磁場発生手段が発生する静磁場を、付加的な磁場を発生させて均一に維持する方法であって、静磁場の空間分布の不均一成分の温度依存性を求めるステップと、静磁場発生手段の温度を検出するステップと、検出された温度および前記温度依存性に基づき前記付加的磁場の強度を求めるステップとを含む。

【0017】

本発明の静磁場均一度維持方法は、温度検出から付加的磁場の発生までのステップを常時動作させてもよいし、必要に応じて或いは定期的に動作させてもよい。【発明の実施の形態】

以下、本発明の好適な実施例を図面を参照して説明する。

【0018】

図1は本発明を適用したMRI装置の全体構成図である。このMRI装置は被検体1が置かれる空間を挟むように配置された静磁場発生磁石2と、この静磁場発生磁石2の内側にそれぞれ配置された傾斜磁場コイル3と、さらにその内側に配置された高周波コイル5と、被検体1から発生するNMR信号を検出する検出コイル7とを備えている。さらに各コイルの動作タイミングを制御するシーケンサ9と装置の制御を行うとともにNMR信号を処理し画像化する計算機10を備えている。

【0019】

静磁場発生磁石2は、図示する実施例では対向した一对の超電導コイル16と、この超電導コイル16を囲むように磁気回路を構成する鉄ヨーク17から構成され、被検体1の周りにその体軸と直交する方向に均一な静磁場を発生させる。その磁場強度は例えば0.5テスラで、磁束の方向は矢印18に示すように床から天井に向っており、その磁場均一度は被検体1が配設される直径40センチメートルの球空間で約5ppm以下になるように調整されている。この磁場均一度調整は超電導コイル16の表面に複数の磁性体小片（図では記載されていない）を貼り付けるパッシブシミング方式が用いられている。

【0020】

傾斜磁場コイル3は、互いに直交するx、y、zの3軸方向に磁束密度を変化させるように巻かれた3組の傾斜磁場コイル3からなり、それぞれ傾斜磁場電源

4に接続され、傾斜磁場発生手段を構成する。後述のシーケンサ9からの制御信号に従って傾斜磁場電源4を駆動して傾斜磁場コイル3に流れる電流値を変化させることにより3軸からなる傾斜磁場 G_x 、 G_y 、 G_z を被検体1に印加するようになっている。この傾斜磁場は、被検体1の検査部位から得られるNMR信号の空間的な分布を把握するのに用いられる。

【0021】

高周波コイル5は、高周波コイル5に高周波電流を流すための高周波電力アンプ6に接続され、被検体1の検査部位の原子核（通常、水素原子核が用いられる）を共鳴励起するための高周波磁場を発生する。高周波電力アンプ6はシーケンサ9の制御信号で制御されている。

【0022】

検出コイル7は、受信器8に接続されており、NMR信号を検出する手段を構成する。受信器8は検出コイル7で検出したNMR信号を増幅・検波するとともに、計算機10による処理が可能なデジタル信号に変換する。受信器8もシーケンサ9でその動作タイミングが制御されている。

【0023】

計算機10はデジタルに変換されたNMR信号を用いて画像再構成、スペクトル計算等の演算を行なうとともに、シーケンサ9を介してMRI装置の各ユニットの動作を定められたタイミングで制御する。計算機10とデータを記憶する記憶装置12と処理後のデータを表示するディスプレイ装置11とで演算処理系が構成される。

【0024】

さらにこのMRI装置は、上述した各要素に加え、静磁場発生磁石2の発生する磁場の均一度を維持するための磁場補正系が設けられている。磁場補正系は、温度を検出し、検出温度に対応する電気信号を出力する温度計13と、この温度計13の出力信号値に合わせてその出力電流を変化させるシム電源14と、その出力電流を流して補正磁場（付加的磁場）を発生するシムコイル15とからなる。

【0025】

温度計13は図示する実施例では、静磁場発生磁石2の鉄ヨーク17に設置さ

れ、鉄ヨークの温度を検出する。シムコイル 1 5 は静磁場の不均一成分に対応して、 z^2 項の磁場を発生するコイル、 xy 項の磁場を発生するコイルなど 1 ないし複数のコイルからなり、超電導コイル 1 6 と傾斜磁場コイル 3 の間に配設されている。尚、1 次項の補正磁場を発生するシムコイルは傾斜磁場コイル 3 がそれを兼ねている。

【0 0 2 6】

次にこのような構成の MRI 装置において静磁場の均一度を維持するための方法を図 2 に示すフロー図に基づき説明する。

【0 0 2 7】

まず予め温度と磁場の不均一との関係、即ち磁場不均一の温度特性を測定しておく。磁場の不均一の温度特性は、シムコイルの成分に対応する各成分毎に、温度変化によって生じる不均一の量（誤差量）を測定する（ステップ 27）。

【0 0 2 8】

既に述べたように静磁場発生磁石 2 は磁性体小片を用いたパッシブシムで調整されており、図 3 に示すように、例えば 23℃ の温度で最も磁場均一度が高く、被検体 1 が配設される空間（直径 40 センチメートルの球空間）で 5 ppm 以下になっている。静磁場発生磁石 2（特に、鉄ヨーク 1 7）の温度が 23℃ から変化するにつれ、磁場均一度は 5 ppm から劣化している。これは、磁気回路を構成する鉄ヨーク 1 7 の熱膨張により、わずかに磁石の構造が歪むことが原因である。

【0 0 2 9】

このような磁場の不均一は、 y の 1 次項成分（以下、 y 成分という）、 z の 2 次項成分（以下、 z^2 成分という）等の各成分の不均一を合わせたものであり、例えば y 成分では図 4 に示すように 1℃ の温度変化に対して約 6 ppm 変化し、 z^2 成分では約 3 ppm 変化している。ステップ 2 7 ではこのように磁場不均一成分（以下、誤差成分という）毎の温度特性を求めておく。

【0 0 3 0】

一方、各シムコイルについてシム特性を求めておく（ステップ 28）。シム特性とは、単位あたりの電流を流したときにシムコイルが発生する磁場強度であり、シム特性を求めておくことにより、所望の磁場強度を発生させるために必要な電

流値が求められる。図 1 に示す MRI 装置では、例えば z 2 のシムコイルは 1 アンペアの電流を流すことによって、z 2 成分の磁場を直径 40 センチメートルの球空間に 5 ppm 発生することができるように大きさと巻数のコイルに製作されている。

【 0 0 3 1 】

次に、静磁場発生磁石 2 の温度を測定する（ステップ 29）。この測定温度と基準温度（静磁場均一度が最良となる温度、例えば 23℃）との温度差から各磁場成分毎に誤差成分変化量を求める（ステップ 30）。この誤差成分変化量は、予め求めた誤差成分毎の温度特性（図 4）を用いて求めることができる。

【 0 0 3 2 】

次いでこの誤差成分変化量を打ち消す補正磁場を発生するシム電流をシムコイル毎に計算し、この電流をシムコイルに供給する（ステップ 31、32）。例えば図 4 に示す例で、温度差が + 1℃であるとする z 2 成分の誤差成分変化量は 3 ppm であるから、－ 3 ppm 発生するようなシム電流（前掲の例で 3 / 5 アンペア）を z 2 のシムコイル（シム特性 5 ppm/A）に流すことにより、温度に起因する静磁場不均一をなくすることができる。

【 0 0 3 3 】

このように複数のシムコイルのそれぞれについて検出温度に基づきシム電流を求め、電流を流すことにより、静磁場発生磁石 2 の磁場均一度を温度の変化に関係なく最適な 5 ppm 以下の値に維持することができる。

【 0 0 3 4 】

尚、図 2 に示す各ステップ 29～31 は、常時動作させるようにしてもよいが、各検査毎に或いは一定時間毎に行なってもよい。さらに温度変化が一定の範囲を超えた場合にのみ行なうようにしてもよい。

【 0 0 3 5 】

以上説明したシムコイルの制御（ステップ 29～31）は、例えばシム電源 1 4 に内蔵したマイクロコンピュータ或いは MRI 装置の計算機 1 0 のプログラマブル制御としてもよいが、アナログ回路による制御も可能である。

【 0 0 3 6 】

図 5 にシム電源 1 4 をアナログ制御回路で構成した実施例を示す。シム電源 1

4は温度計からの出力電圧を入力する電圧増幅器19と、複数のシムコイル15a、15b、15cに対応した複数の可変抵抗器22a、22b、22cと、電圧／電流変換器23a、23b、23cとを備えている。温度計13の出力電圧Vはシム電源14の電圧増幅器19の入力端子20に加えられる。

【0037】

温度計13の出力電圧は、温度指示値が基準温度（例えば23℃）に所定の出力電圧 v を発生し、温度が1℃上昇する毎にその端子電圧が所定量 Δv 増加するようになっている。温度計13の出力電圧 v は電圧増幅器19に入力される。

【0038】

電圧増幅器19は、 $-v$ ボルトのオフセット調整がなされており、（入力電圧 $-v$ ）を n 倍に増幅し、その出力電圧は可変抵抗器21a～21cの一端に加えられる。即ち、電圧増幅器19は、温度は1℃上昇する毎に $n\Delta v$ ボルトの電圧を発生する。

【0039】

可変抵抗器21a～21cの他端は接地され、その電圧は0なので、可変端子22a～22cの電圧は、それぞれの可変抵抗器21a～21cの調整により0から nV の間の任意の値を選択することができる。可変端子22a～22cの電圧は電圧／電流変換器23a～23cの入力端子24a～24cに印加されている。各電圧／電流変換器24a～24cにはその出力電流に一定のオフセット電流を加える調整抵抗器25a～25cが付加されている。電圧／電流変換器23a～23cの出力端子26a～26cは各補正磁場成分を発生するシムコイル15a～15cに接続され、その電流が各シムコイルに流れるようになっている。

【0040】

ここで、シムコイル15aのシムコイル特性、即ちシムコイルに単位当りの電流を流したときの磁場変化を ε_0 (ppm/A)、シムコイル15aに対応する誤差成分の+1℃当りの磁場変化を ε_1 (ppm/℃)とすると、+1℃の温度変化によって生じた磁場変化を相殺するのに必要な電流 I [A/℃]は $I = \varepsilon_1 / \varepsilon_0$ である。一方、+1℃の温度変化を検出した電圧増幅器19の出力 $n\Delta v$ [V/℃]によって、シムコイル15aに供給される電流 I' は、可変抵抗器21aの入力電圧に対する

出力電圧の比を x 、電圧／電流変換器 2 3 a の変換率を c [A/V] とすると、 $I' = n \Delta v \cdot x \cdot c$ となる。従って $I = I'$ とするためには、可変抵抗器 2 1 a を、その入力電圧に対する出力電圧の比 (x) が次式 (1) を満たすように調整すればよいことになる。

【0 0 4 1】

$$n \Delta v \cdot x \cdot c = \varepsilon 1 / \varepsilon 0$$

$$x = \varepsilon 1 / (\varepsilon 0 \cdot c \cdot n \Delta v) \quad (1)$$

これにより、自動的に温度変化に対応した磁場補正が可能となる。

【0 0 4 2】

例えば、温度計 1 3 の出力電圧は基準温度の時に 0.5 ボルトで、1℃温度が上昇するとその端子間電圧は 0.2 ボルト増加するように設定されているとする。電圧増幅器 1 9 はその増幅率が 5 倍であるとする、-0.5 ボルトのオフセット調整がされているので、1℃温度が上昇すると 1 (0.2×5) ボルトを出力する。

【0 0 4 3】

一方、静磁場発生磁石 2 の 1℃の温度変化で $z 2$ の補正磁場は 3 ($\varepsilon 1$) ppm が必要となる。 $z 2$ のシムコイル 1 5 a のシム特性 $\varepsilon 0$ が 5 ppm/A であるとする、この 3 ppm を $z 2$ のシムコイル 1 5 a で発生させるには、0.6 アンペアの電流を流す必要がある。

【0 0 4 4】

従って、電圧／電流変換器 2 3 a が 1 ボルトの入力信号を 1 アンペアの出力信号に変える、即ち変換率 c が 1 であるとする、可変抵抗器 2 1 a はその可変端子 2 2 a を 60% ($x = 0.6$) の位置に調整することにより、電圧／電流変換器 2 3 a は 0.6 アンペアの電流を出力し、補正磁場 3 ppm の発生に必要な電流をシムコイル 1 5 a に供給することができる。

【0 0 4 5】

このように可変抵抗器 2 1 a の調整を行っておくことにより、静磁場発生磁石 2 の温度変化にあわせて $z 2$ の補正磁場成分が発生させることができる。即ち、前掲の例で、温度変化 1℃あたり、 $z 2$ の誤差成分の発生量 3 ppm とシムコイル 1 5 a の補正磁場の発生量 - 3 ppm とが絶対値で一致することになり、温度変化に影

響されず磁場均一度が 5 ppm に維持される。

【0 0 4 6】

以上の説明はシムコイル 1 5 a を例にしたが、y 成分やその他の成分についてもそのシム特性 ε_0 および成分の温度特性 ε_1 がわかっていれば、式 (1) から同様に可変抵抗器 2 1 の調整を行うことができ、これによりすべての成分について高い磁場均一度を維持することができる。尚、y 成分を補正するシムコイルが y 軸の傾斜磁場コイルを兼ねる場合には、上述のシム電流は撮影に際して y 軸の傾斜磁場コイルに印加される傾斜磁場電流に重畳して印加される。

【0 0 4 7】

以上説明した磁場均一度維持方法によれば、温度変化に伴って変化の大きな磁場の誤差成分を優先して補正することができるので、効率的に磁場均一度を維持することができる。また、磁場の誤差成分の温度変化の割合を予めとらえて補正することができるので、正確に誤差成分を補正することができる。また温度変化と補正磁場の発生までを容易に制御ループで構成することが可能となり、煩わしい操作を自動化することができるとともに、常時補正機能を働かせることができる。

【0 0 4 8】

尚、図 1 に示す実施例では、温度の計測を静磁場発生磁石 2 の鉄ヨーク 1 7 に取付けた温度計 1 3 で行なったが、温度計 1 3 は静磁場発生磁石 2 の近傍に設置されていてもよく、また静磁場発生磁石 2 が設置された測定室の室温計を用いることも可能である。この場合には、シムコイルの制御回路（シム電源 1 4）に、検出温度に対応する電気信号を与えるために、温度設定手段を設けることが必要である。温度設定手段は MRI 装置の操作部に一体的に設けてもよいし、シム電源 1 4 に付属して設けてもよい。

【0 0 4 9】

この温度設定手段は、図 5 の制御回路において温度計 1 3 と置換することができ、設定された温度に対応する電気信号を電圧増幅器 1 9 に送出する。温度設定手段で設定された温度に基づきシム電源 1 4 でシム電流を求め、シムコイルに供給することは上述した実施例と全く同様であり、同様の効果を得ることができる。

。但し、この場合は、室温の変化と静磁場発生磁石 2 の温度変化の時間的な遅延を考慮することが必要である。尚、温度設定手段では、室温をそのまま数値で入力してもよいが、一般に計測室の室温は±5℃以内に保たれているので、例えば「高-中-低」というような設定を行うようにしてもよい。

【0050】

また以上の実施例では、磁石の温度による磁場の不均一成分のみを補正する場合を説明したが、従来のアクティブシミング等を併用することも可能である。例えば、被検体の検査部位のNMR信号を検出、検出したNMR信号を解析してシムコイルに補正電流を流して磁場の均一度を改善する方法を併用する方法も可能であり、そのような実施例を図6を参照して説明する。

【0051】

この実施例では、まずMRI装置による検査の前段階で温度による磁場不均一の補正を行う(601~603)。この実施例でも予め各誤差成分について温度特性および各シムコイルのシム特性を求めておくことは図2の実施例と同じである。検査前に、磁石の温度を計測し(601)、磁石を最良の磁場均一度に調整した温度(基準温度、例えば23℃)と計測温度との差を求め、予め求められた誤差成分の温度特性から磁場の誤差成分量を求める(602)。次いで磁場誤差成分を補償する補正磁場を発生するシム電流を求め、この電流をシムコイルに流す(603)。この段階で磁場均一度は基準温度のときと同様の磁場均一度が達成される。

【0052】

次に被検体を配置した状態で磁場均一度の補正を行う(604~607)。まず被検体の検査部位が磁石のほぼ中心になるように被検体を装置内に配置する(604)。次に被検体の検査部位に高周波パルスを印加し、検査部位からNMR信号を検出する(605)。このNMR信号を処理し磁場の誤差成分を計算する(606)。ここでの磁場の誤差成分は、被検体の検査部位の磁化率によって磁場均一度が乱されることによって生じたものであり、例えばNMR信号の位相差を求めることにより計算することができる。この誤差成分を補償する補正磁場を発生するシム電流を計算する(607)。

【0053】

上述したステップ604～607と平行して、定期的に磁石の温度変化に伴う磁場変化の補正を行う（608～611）。これらステップ608～611は、検査前の補正ステップ601～603と同じであり、一定の時間の経過を判断し（611）、一定時間経過した場合にのみ磁場補正を行う。この時間の設定は周囲温度の変化率と磁石の温度時定数を考慮して決定される。

【0054】

このステップ610で計算されたシム電流は、ステップ607で計算されたシム電流と重畳されシムコイルに供給される（612）。これにより被検体の磁化率の影響による誤差成分と、磁石の温度変化による磁場の誤差成分の両方が補正され、高度の磁場均一度が達成される。この状態で被検体の検査を開始する（613）。必要があれば次の検査を続行する（614）。

【0055】

この実施例の場合は、磁石の温度変化による磁場不均一成分の補正ができるだけでなく、被検体の検査部位自体の磁化率の影響による磁場不均一成分をも補正できるので、より磁場均一度の高いMRI装置が実現できる。従って、脂肪信号のみを抑制した画像やEPIなどの高度の磁場均一度を必要とする撮影手法において高品質の画像を得ることができる。

【0056】

本発明は、以上説明した方法や装置に限定されず、種々の変更が可能であり、他の磁場均一維持手段や方法との併用も可能である。例えば、図1に示すMRI装置は静磁場発生磁石として超電導コイルを用いているが、静磁場発生磁石は常電導コイルであっても永久磁石であってもよい。また図1には被検体の体軸と直交する方向に静磁場を発生させる装置を示したが、本発明は被検体の体軸と平行な方向に静磁場を発生させる装置であっても適用することができる。

【0057】

【発明の効果】

本発明によれば、磁石またはその周囲の温度変化に応じて磁場均一度を補正するようにしたので、温度に影響されることなく、磁場均一度を高い値に維持することができる。この結果MRI検査データの信頼性を高めることができる。また本

発明によれば温度変化による磁場不均一のみを効率よく補正することができ、撮影時間の短縮を図ることができる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】 本発明が適用される MRI 装置の全体構成を示す図。

【図 2】 本発明による磁場均一度維持方法の一実施例を示すフローチャート

。

【図 3】 静磁場発生磁石の磁場均一度の温度特性を示す図。

【図 4】 誤差成分 y 、 z 2 の温度特性を示す図。

【図 5】 図 1 の MRI 装置の磁場補正系の詳細を示す図。


【図 6】 本発明による磁場均一度維持方法の他の実施例を示すフローチャート。

【符号の説明】


- 1 ……被検体
- 2 ……静磁場発生磁石
- 3 ……傾斜磁場コイル
- 4 ……傾斜磁場電源
- 5 ……高周波コイル
- 6 ……高周波電力アンプ
- 7 ……検出コイル
- 8 ……受信器
- 1 0 ……計算機（信号処理手段）
- 1 3 ……温度計（温度検出手段）
- 1 4 ……シム電源（制御する手段）
- 1 5 ……シムコイル（磁場補正手段）

【書類名】 図面


【図 1】

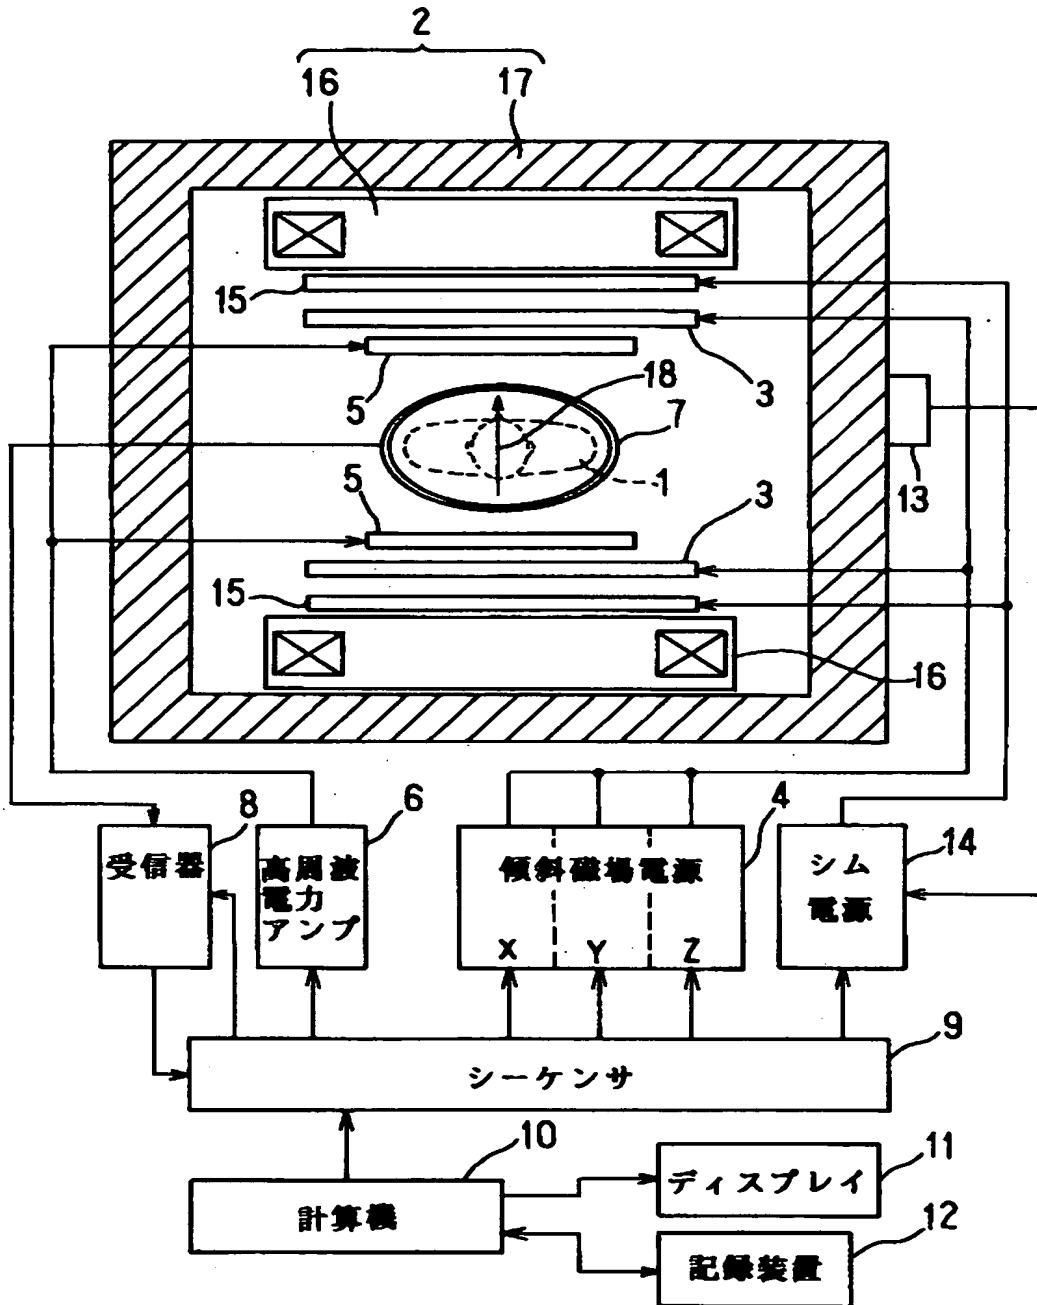


【図 2】

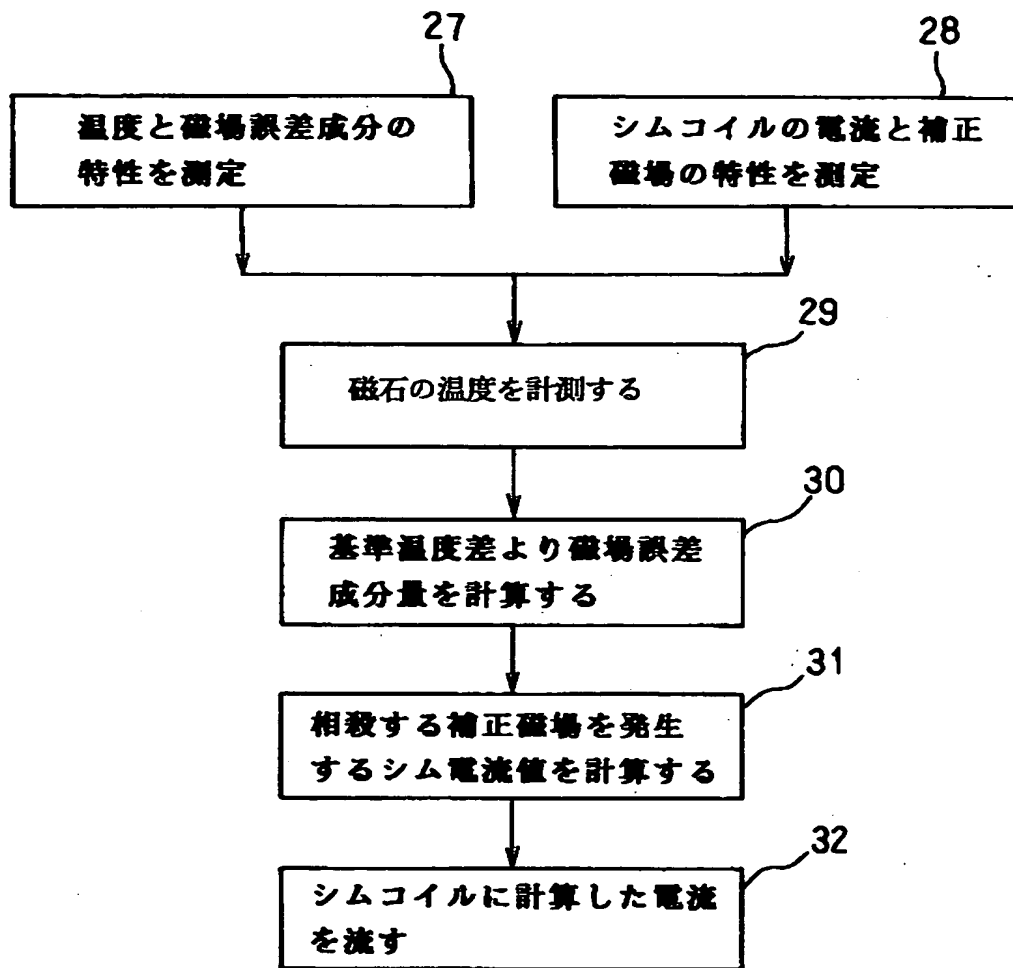


【図 3】

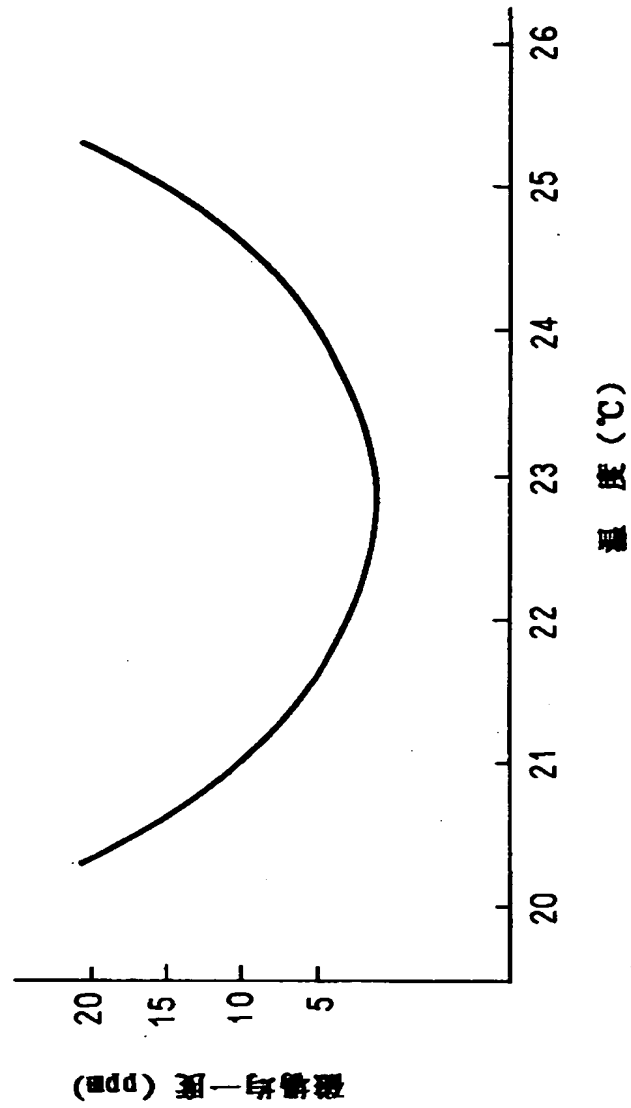


【図 4】

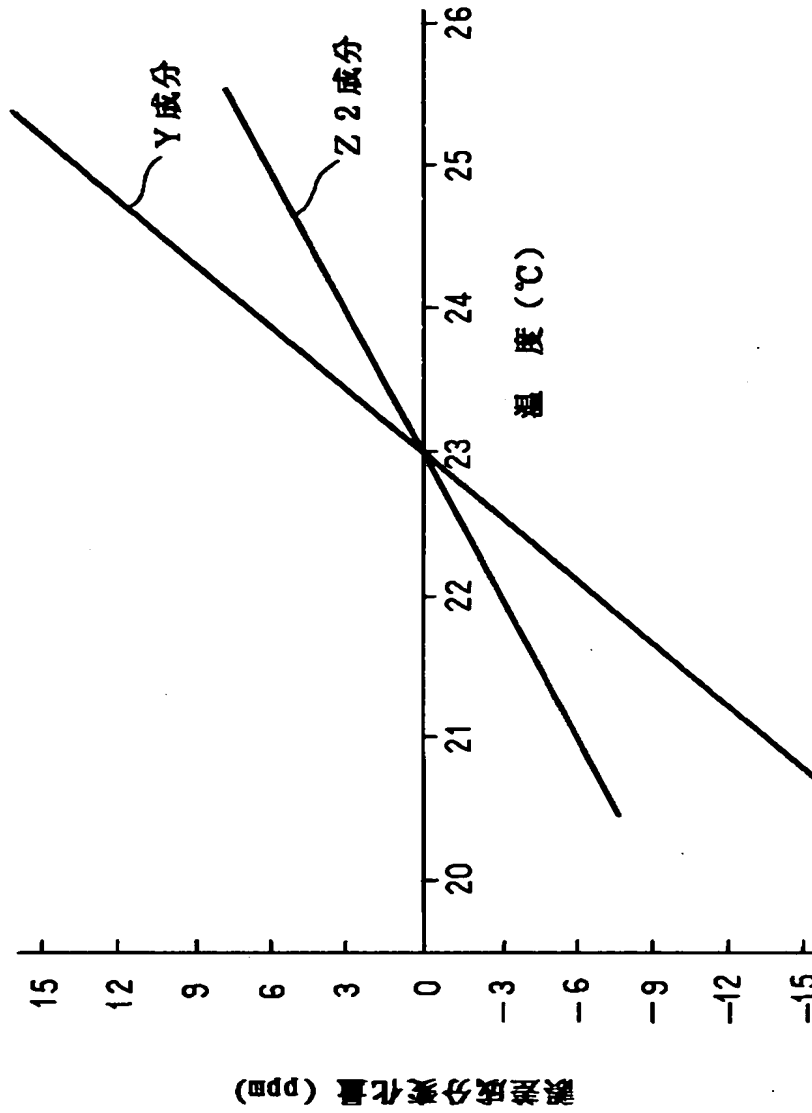

【図 5】

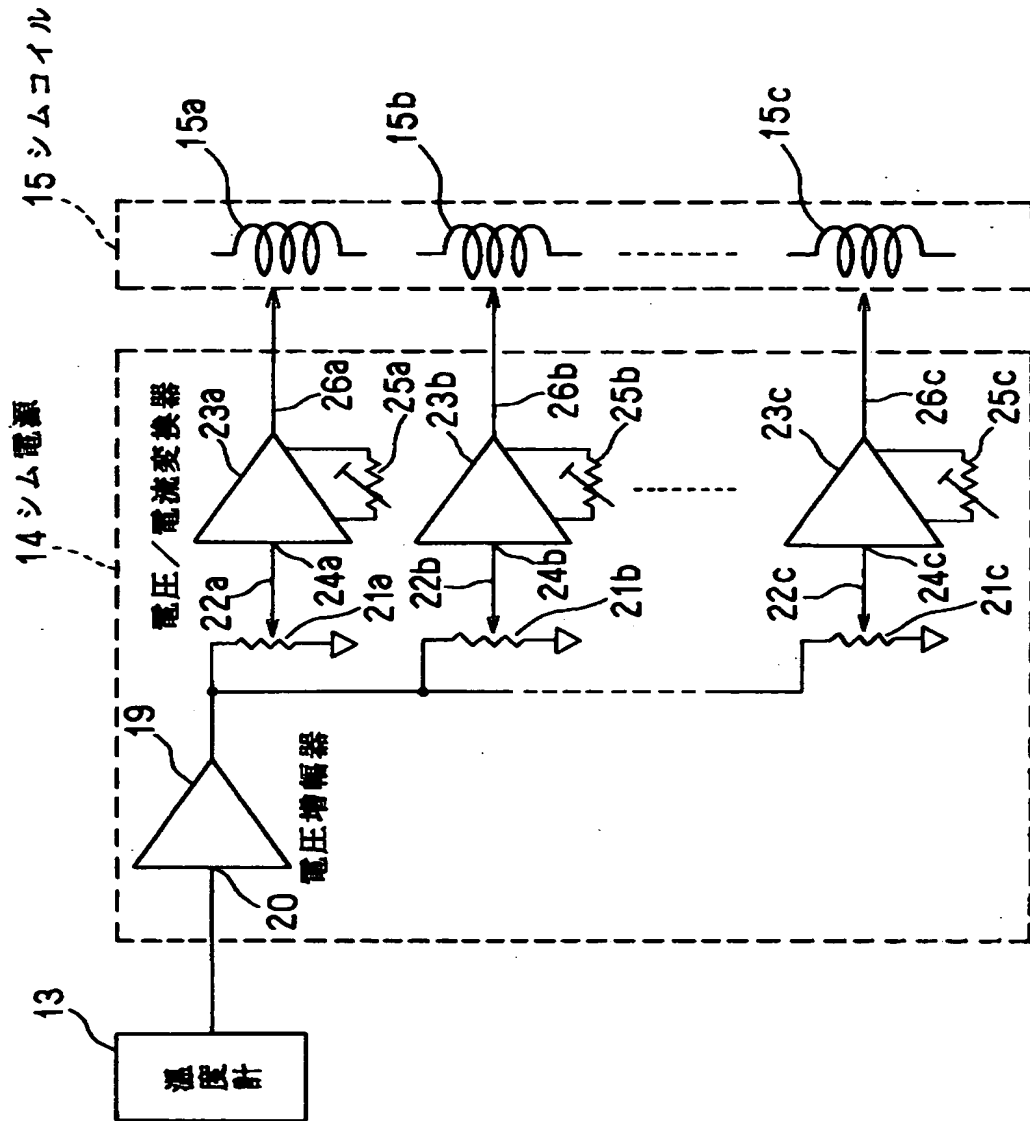

【図 6】

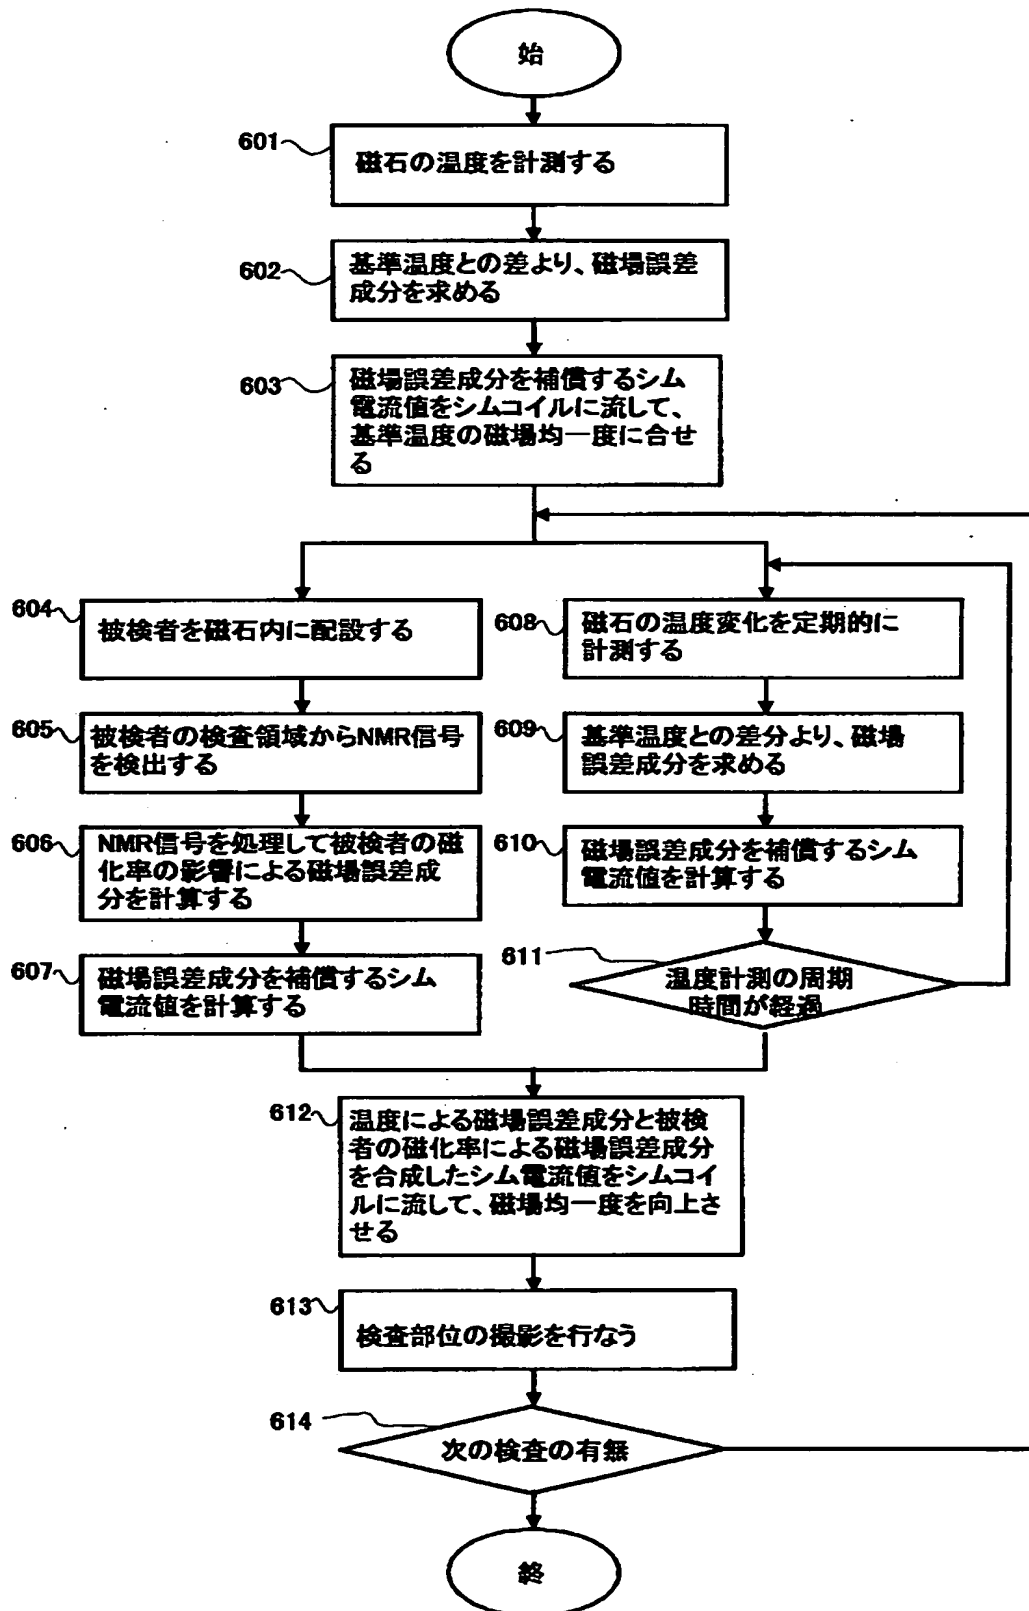

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】磁石の温度変化に合わせて磁場不均一を解消し、磁場均一度が高く、高い信頼度の検査を実現できるMRI装置を提供する。

【解決手段】MRI装置は、磁場の均一度を補正する手段（シムコイル）と、磁石又はその周辺の温度を検出する手段と、この検出温度に基づきシムコイルを制御する手段とを備えている。制御手段は、予め計測された磁場均一度の温度特性に基づき（27）、検出された磁石又はその周辺の温度における磁場均一度を変化させる誤差成分を求める（29、30）。さらにこの誤差成分を相殺する補正磁場を発生させるためのシム電流を計算し（31）、このシム電流でシムコイルを駆動する。

【選択図】 図 2

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [000153498]

1. 変更年月日 1990年 8月10日

[変更理由] 新規登録

住 所 東京都千代田区内神田1丁目1番14号

氏 名 株式会社日立メディコ